

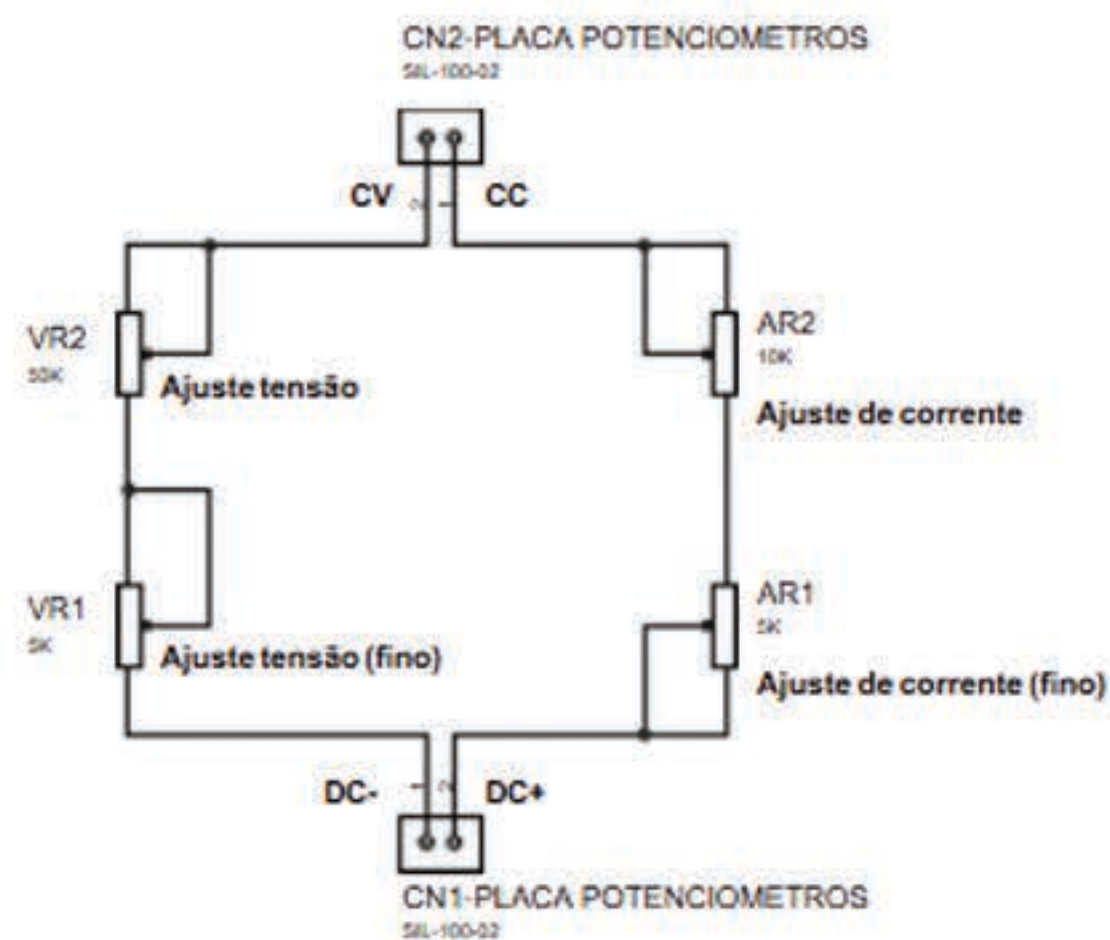


HIKARI HF-3003S

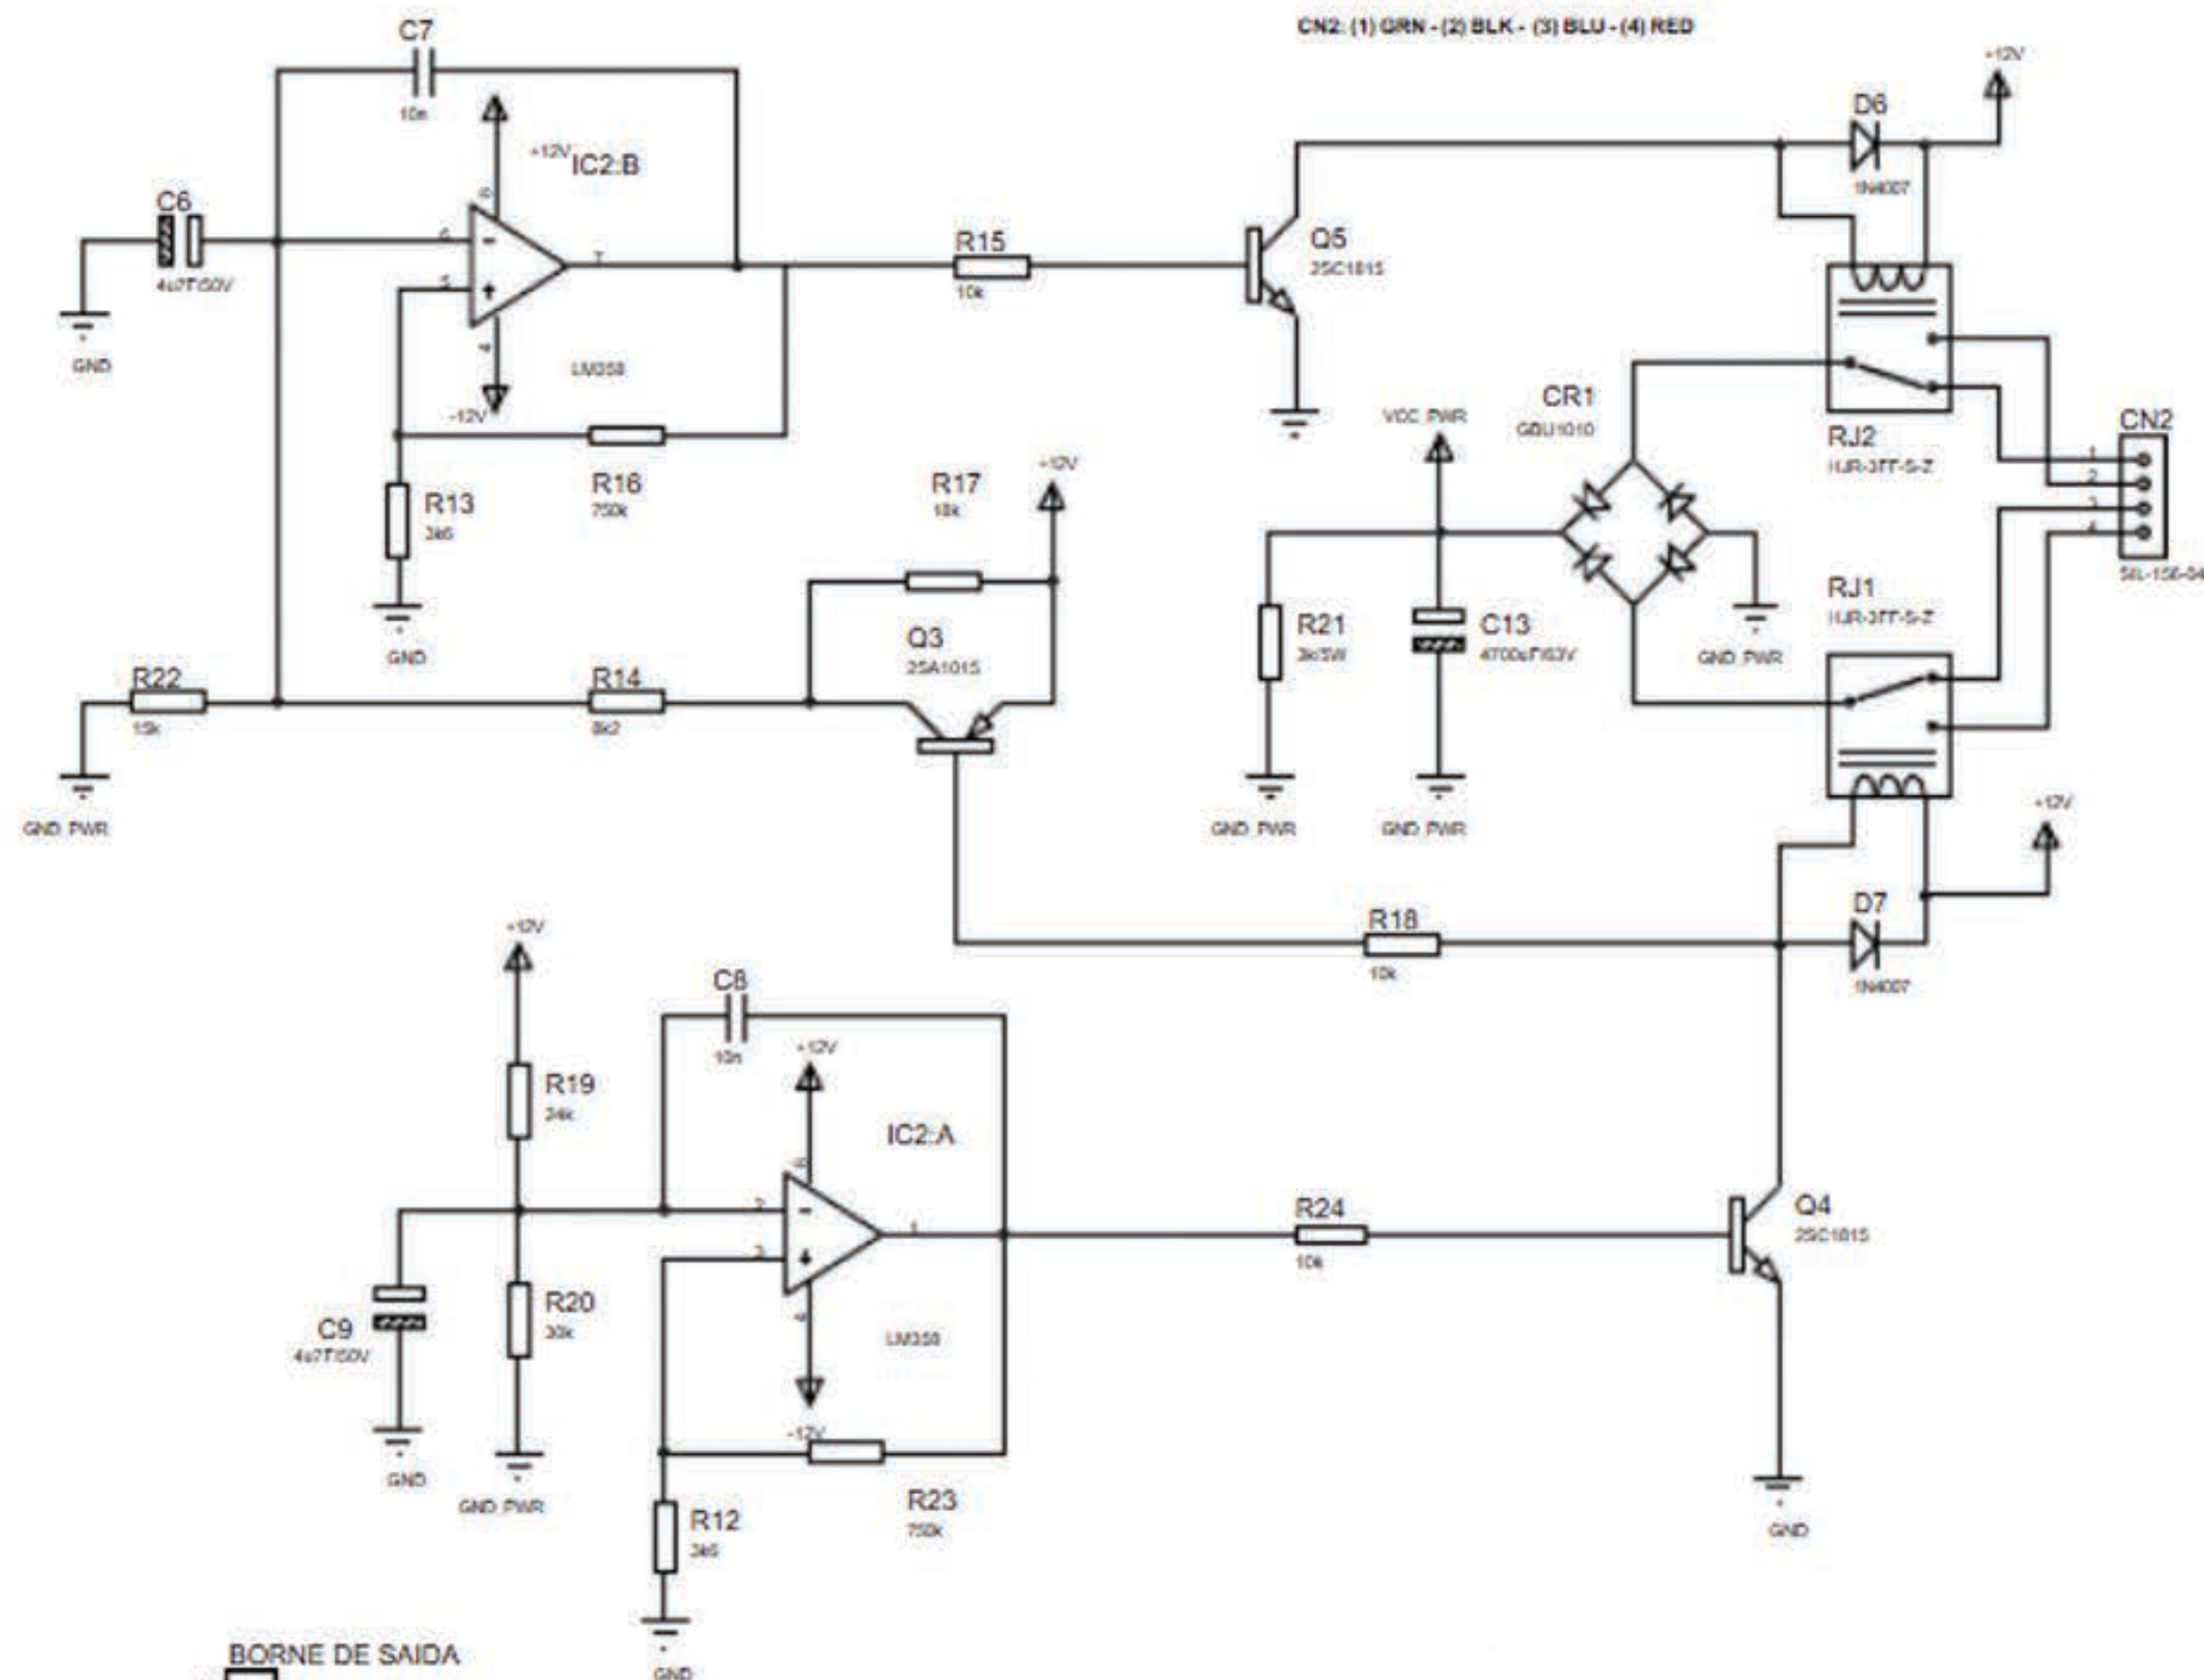

Terminal #1-CN2 vai para terminal #4-CN5 na placa de controle/potência
Terminal #2-CN2 vai para terminal #3-CN5 na placa de controle/potência

CN2 vai para placa medição/display. CN2: #1(red) e #2(blk)
CN4: terminal #1 vai para terminal #1-CN5 na placa de controle/potência
CN4: terminal #2 vai para terminal #2-CN5 na placa de controle/potência
CN3: terminal #1 vai para terminal #2-CN1 na placa dos potenciômetros
CN3: terminal #2 vai para terminal #1-CN1 na placa dos potenciômetros

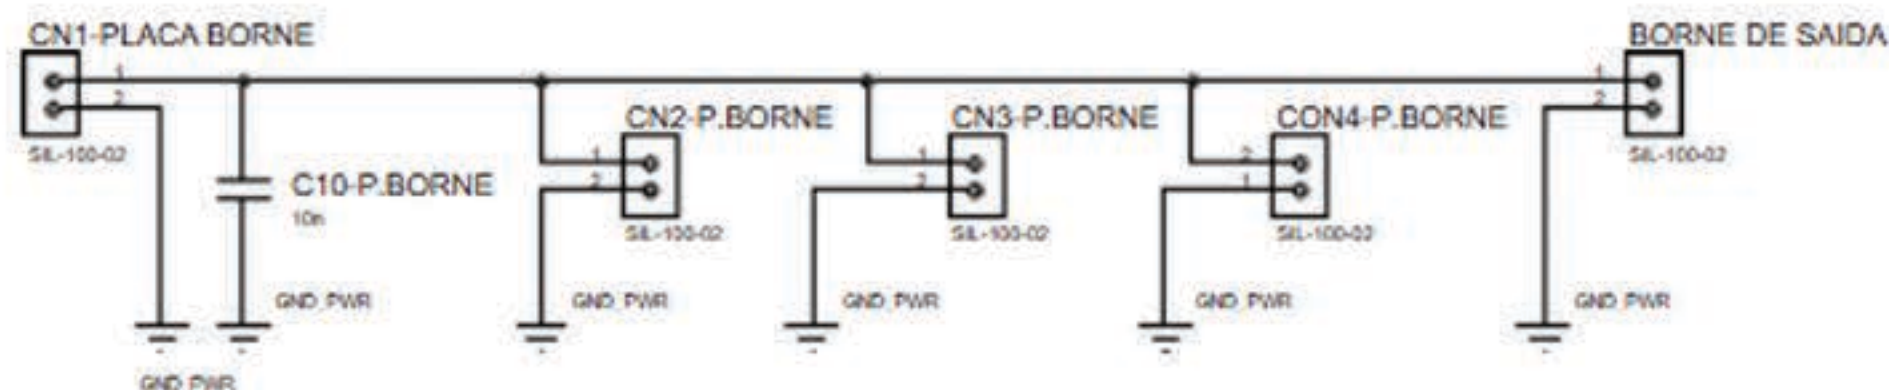

Atenção: temos um GND (circuito controle) e um GND_PWR (da tensão de saída - nos bornes).
Placa controle/potência: ATEN SAT7.820.688C
Placa potenciômetros ajustes tensão/corrente: ATEN SAT7.820.529C
Placa bornes de saída: ATEN SAT7.820.530B

HIKARI HF-3003S